

Guide d'utilisation Quadtro Select





permobil

Coussin ROHO QUADTRO SELECT


Prévention anti escarre +++ et Positionnement +++

4 compartiments permettent le positionnement spécifique du bassin

Ouvert - bouton
vert enfoncé

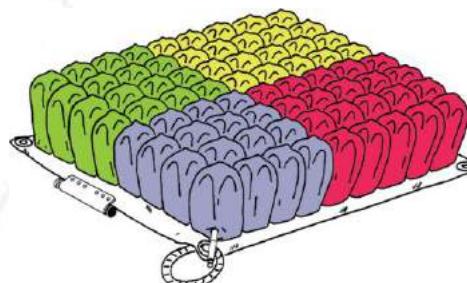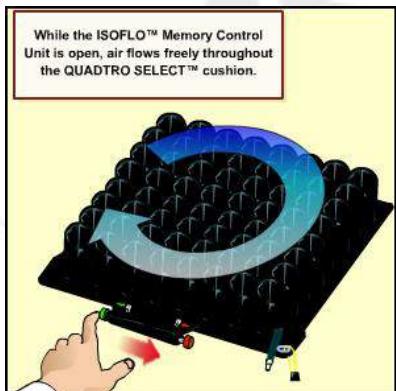

Fermé - bouton
rouge enfoncé

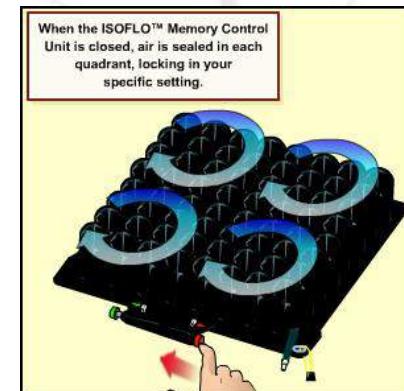


permobil

Ajustement de ROHO® QUADTRO SELECT®



A
Gonfler

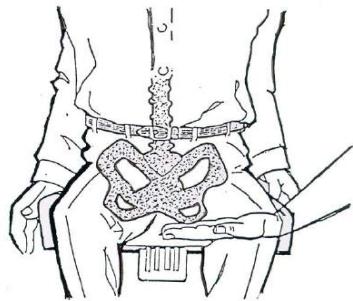

C
Positionner




B
Ajuster



permobil

Étape 1 - Surgonfler le coussin

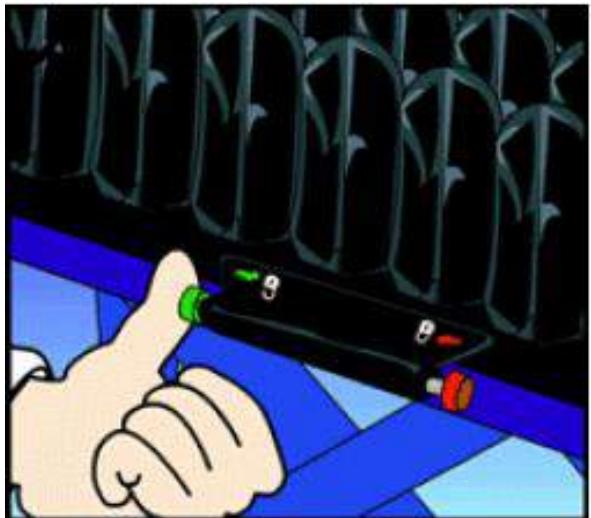


ISOFLOW OUVERT (bouton vert appuyé) ROHO

Remarque : le coussin peut être gonflé lorsque le patient est assis sur le coussin

permobil

Étape 2 - Positionner l'utilisateur sur le coussin



- Vérifiez que l'utilisateur est assis le plus au fond possible dans le fauteuil.
- Vérifiez que les repose-pieds et accoudoirs sont bien réglés.
- Vérifiez que l'utilisateur est assis en position de repos normale.

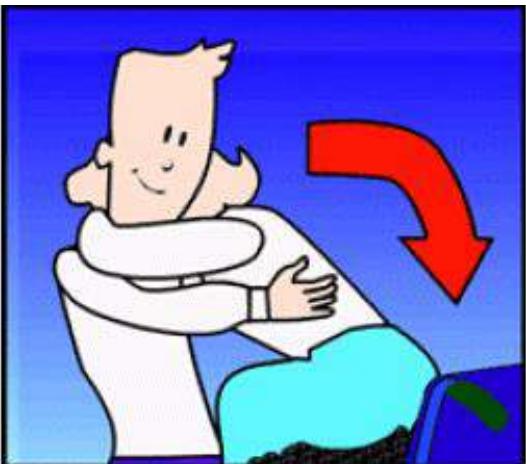

permobil

Étape 3 – Ajuster le coussin

Glissez la main sous l'ischion **le plus bas**

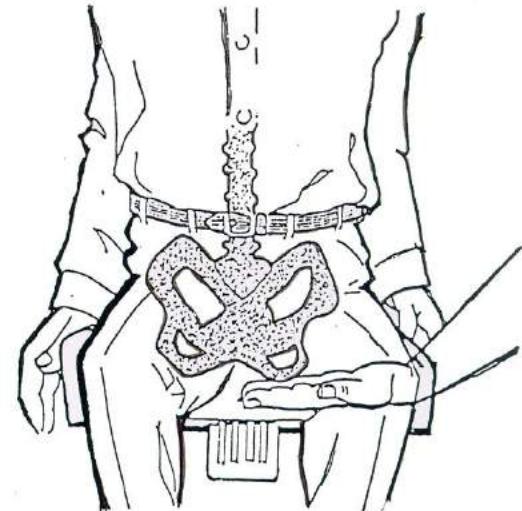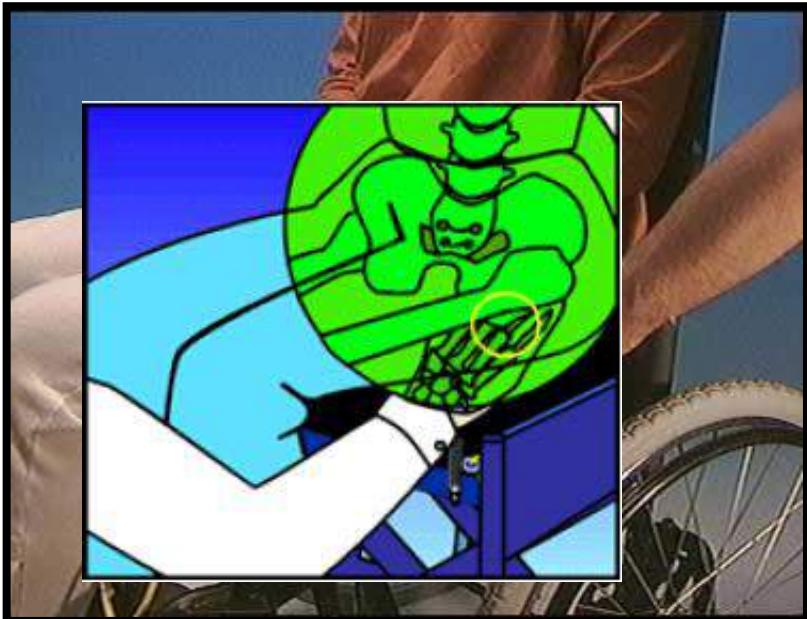


Remarque : inutile de retirer la housse pour effectuer un ajustement précis

permobil

Étape 4 – ouvrir la valve et laisser sortir l'air

Lorsque la main touche le bas/la base, refermez la valve.
Il doit rester environ 1,5 cm d'air entre l'utilisateur et la base.

L'utilisateur doit être DANS le coussin et PAS SUR le coussin.

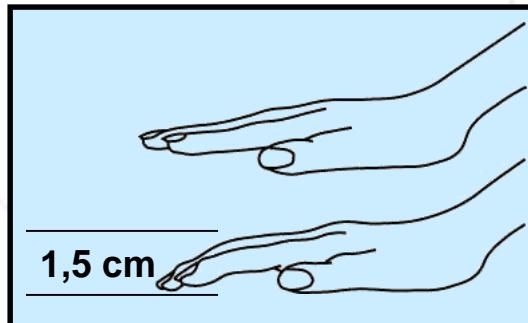


1,5 cm entre
l'utilisateur et la
base.

Le coussin est maintenant bien réglé

permobil

Étape 5 – Positionnement

Positionner la personne dans la position souhaitée
Bloquer la position en appuyant sur le rouge

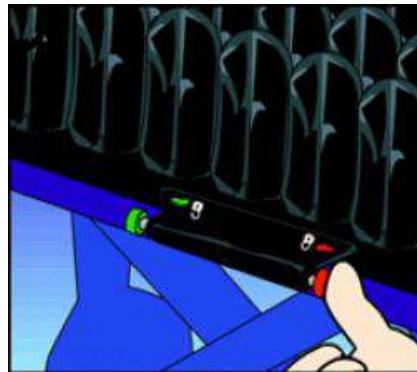

Obliquité de bassin : + d'air d'un côté :
pencher d'un côté ou de l'autre

Rétroversion de bassin : + d'air en
avant : lever les jambes

permobil